

VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok


Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT

UDI-DI: 5999861787029

A „VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok” gyűrűskönyvben, egy olyan segédeszköz, amely a kisgyermekek látásélesség-vizsgálatához nyújt segítséget abban az esetben, ha a vizsgálat a VISUS-S vagy VISUS-D látásélesség-vizsgáló táblával a hagyományos módon nem végezhető el. A vizsgálatot a lapok (kártyák) segítségével „játékos” formában lehet elvégezni.

A gyűrűskönyv 12 db „**Vizsgáló kártyát**”, 1 db „**Összesítő kártyát**” és 1 db „**Segédkártyát**” tartalmaz. A **Vizsgálókártyák** egyik oldalán a Kettessy-tábla egyik „Ammon” jele (villa), a hátoldalukon egy vagy több, hasonló láthatóságú ábra található, az **Összesítő kártyán** látható rajzok („óvodai jelek”) közül. A 3 m-es vizsgálati távolságú Kettessy-féle tábla „Ammon jeles” változata középső oszlopának mindegyik jele megtalálható a kártyasorozat egy-egy lapján. Minden kártyán jelölve van, hogy mennyi a rajta levő Ammon-jel visus-értéke. *(Rendelhető „C” jeles változatban is.)*

A segédkártyán a szabványos „Ammon” jeles Kettessy-féle tábla kicsinyített rajza látható. A lap szélén az ábrák visus-értéke is fel van tüntetve, így a vizsgálatot végző személy azonosítani tudja, hogy a kártyákon található jelek a falitáblán hol helyezkednek el.

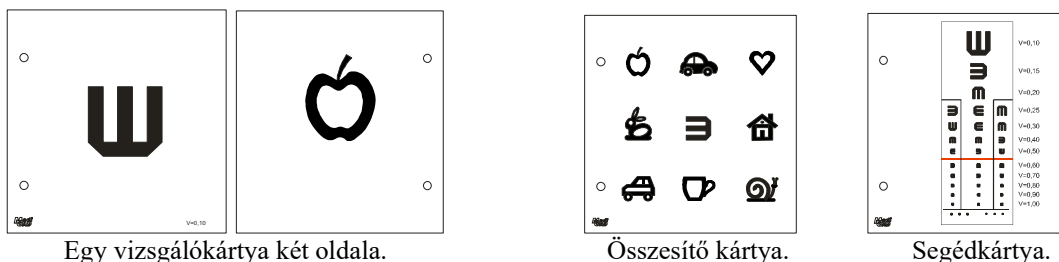

Egy vizsgálókártya két oldala.

Összesítő kártya.

Segédkártya.


A látásélesség-vizsgálat menete:

- A vizsgálatot jól megvilágított helyiségben kell végezni. A gyermekkel szemben nem lehet fényforrás vagy ablak.
- A kisgyermeket a vizsgálatot végző személytől 3 m-es távolságban kell leültetni. Lehetőség szerint a vizsgálatot végző is üljön. Ha a szoba megvilágítása nem megfelelő, akkor helyi fényforrást (pl. vizsgáló vagy olvasólámpa) kell a vizsgálatot végző keze felé irányítani.
- A vizsgálat során először fel kell mérni, hogy a gyermek hajlandó-e – a sorban egymás után felmutatott kártyákon – az „Ammon” jelek (villák) irányát megmutatni. (Tapasztalatok szerint a hajlandóság növelhető, ha a jeleket „robotkéznek” nevezzük, és arra kérjük a gyermeket, hogy utánozza a robotot.) Ha hajlandó erre, akkor a vizsgálat – az „Ammon” jelek csökkenő méretű sorrendben történő felmutatásával – a falitáblánál megszokott módon végezhető el.
- Ha nem tudja, vagy nem akarja megmutatni, hogy melyik irányba mutat a villa, akkor lehet a kártyák másik oldalán levő rajzokat segítségül hívni. A gyermek kezébe kell adni az „**összesítő kártyát**”. A gyermek vagy a felismert figura nevét mondja meg, vagy a kezében levő összesítő lapon megmutathatja, hogy mit lát a felmutatott kártyán. Ha ilyen módon sikerült eljutni a legkisebb felismert rajzokig, akkor érdemes megpróbálni, hogy a kártya másik oldalán levő „Ammon” jelet felismeri-e.

A vizsgálat eredménye tájékoztató jellegű!

Az eszköz nem laikus felhasználók, hanem egészségügyi szakemberek (orvosok, védőnők stb.) számára készült!

Tájékoztató adatok:

- Gyártó neve: Medi-CAD Kft.
3531 Miskolc, Gyár u. 62-1.
Tel.: +36 46 369 377
e-mail: medicad@medicad.hu.
web: www.medicad.hu
- Megfelelőség jele: 
- 2017/745 EU rendelet szerinti osztályba sorolás: I. (1. szabály)
- Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT
- UDI-DI: 5999861787029
- Méretek:
 - A gyűrűskönyv mérete: 150x155x35 mm
 - A belső lapok mérete: 130x148x0,5 mm
- A könyv és a lapok anyaga: laminált nyomdai karton

VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok


Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT

UDI-DI: 5999861787029

A „VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok” gyűrűskönyvben, egy olyan segédeszköz, amely a kisgyermek látásélesség-vizsgálatához nyújt segítséget abban az esetben, ha a vizsgálat a VISUS-S vagy VISUS-D látásélesség-vizsgáló táblával a hagyományos módon nem végezhető el. A vizsgálatot a lapok (kártyák) segítségével „játékos” formában lehet elvégezni.

A gyűrűskönyv 12 db „**Vizsgáló kártyát**”, 1 db „**Összesítő kártyát**” és 1 db „**Segédkártyát**” tartalmaz. A **Vizsgálókártyák** egyik oldalán a Kettessy-tábla egyik „Ammon” jele (villa), a hátoldalukon egy vagy több, hasonló láthatóságú ábra található, az **Összesítő kártyán** látható rajzok („óvodai jelek”) közül. A 3 m-es vizsgálati távolságú Kettessy-féle tábla „Ammon jeles” változata középső oszlopának mindegyik jele megtalálható a kártyasorozat egy-egy lapján. Minden kártyán jelölve van, hogy mennyi a rajta levő Ammon-jel visus-értéke. *(Rendelhető „C” jeles változatban is.)*

A segédkártyán a szabványos „Ammon” jeles Kettessy-féle tábla kicsinyített rajza látható. A lap szélén az ábrák visus-értéke is fel van tüntetve, így a vizsgálatot végző személy azonosítani tudja, hogy a kártyákon található jelek a falitáblán hol helyezkednek el.

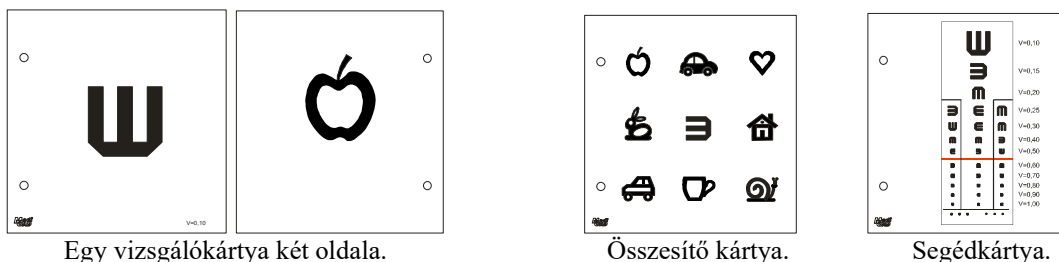


A látásélesség-vizsgálat menete:

- A vizsgálatot jól megvilágított helyiségben kell végezni. A gyermekkel szemben nem lehet fényforrás vagy ablak.
- A kisgyermeket a vizsgálatot végző személytől 3 m-es távolságban kell leültetni. Lehetőség szerint a vizsgálatot végző is üljön. Ha a szoba megvilágítása nem megfelelő, akkor helyi fényforrást (pl. vizsgáló vagy olvasólámpa) kell a vizsgálatot végző keze felé irányítani.
- A vizsgálat során először fel kell mérni, hogy a gyermek hajlandó-e – a sorban egymás után felmutatott kártyákon – az „Ammon” jelek (villák) irányát megmutatni. (Tapasztalatok szerint a hajlandóság növelhető, ha a jeleket „robotkéznek” nevezzük, és arra kérjük a gyermeket, hogy utánozza a robotot.) Ha hajlandó erre, akkor a vizsgálat – az „Ammon” jelek csökkenő méretű sorrendben történő felmutatásával – a falitáblánál megszokott módon végezhető el.
- Ha nem tudja, vagy nem akarja megmutatni, hogy melyik irányba mutat a villa, akkor lehet a kártyák másik oldalán levő rajzokat segítségül hívni. A gyermek kezébe kell adni az „**összesítő kártyát**”. A gyermek vagy a felismert figura nevét mondja meg, vagy a kezében levő összesítő lapon megmutathatja, hogy mit lát a felmutatott kártyán. Ha ilyen módon sikerült eljutni a legkisebb felismert rajzokig, akkor érdemes megpróbálni, hogy a kártya másik oldalán levő „Ammon” jelet felismeri-e.

A vizsgálat eredménye tájékoztató jellegű!

Az eszköz nem laikus felhasználók, hanem egészségügyi szakemberek (orvosok, védőnők stb.) számára készült!

Tájékoztató adatok:

- Gyártó neve: Medi-CAD Kft.
3531 Miskolc, Gyár u. 62-1.
Tel.: +36 46 369 377
e-mail: medicad@medicad.hu.
web: www.medicad.hu
- Megfelelőség jele: 
- 2017/745 EU rendelet szerinti osztályba sorolás: I. (1. szabály)
- Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT
- UDI-DI: 5999861787029
- Méretek:
 - A gyűrűskönyv mérete: 150x155x35 mm
 - A belső lapok mérete: 130x148x0,5 mm
- A könyv és a lapok anyaga: laminált nyomdai karton

VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok


Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT

UDI-DI: 5999861787029

A „VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok” gyűrűskönyvben, egy olyan segédeszköz, amely a kisgyermekek látásélesség-vizsgálatához nyújt segítséget abban az esetben, ha a vizsgálat a VISUS-S vagy VISUS-D látásélesség-vizsgáló táblával a hagyományos módon nem végezhető el. A vizsgálatot a lapok (kártyák) segítségével „játékos” formában lehet elvégezni.

A gyűrűskönyv 12 db „**Vizsgáló kártyát**”, 1 db „**Összesítő kártyát**” és 1 db „**Segédkártyát**” tartalmaz. A **Vizsgálókártyák** egyik oldalán a Kettessy-tábla egyik „Ammon” jele (villa), a hátoldalukon egy vagy több, hasonló láthatóságú ábra található, az **Összesítő kártyán** látható rajzok („óvodai jelek”) közül. A 3 m-es vizsgálati távolságú Kettessy-féle tábla „Ammon jeles” változata középső oszlopának mindegyik jele megtalálható a kártyasorozat egy-egy lapján. Minden kártyán jelölve van, hogy mennyi a rajta levő Ammon-jel visus-értéke. *(Rendelhető „C” jeles változatban is.)*

A segédkártyán a szabványos „Ammon” jeles Kettessy-féle tábla kicsinyített rajza látható. A lap szélén az ábrák visus-értéke is fel van tüntetve, így a vizsgálatot végző személy azonosítani tudja, hogy a kártyákon található jelek a falitáblán hol helyezkednek el.

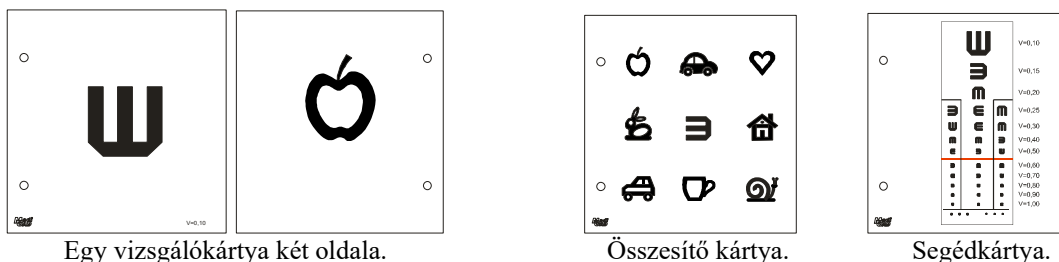

Egy vizsgálókártya két oldala.

Összesítő kártya.

Segédkártya.


A látásélesség-vizsgálat menete:

- A vizsgálatot jól megvilágított helyiségben kell végezni. A gyermekkel szemben nem lehet fényforrás vagy ablak.
- A kisgyermeket a vizsgálatot végző személytől 3 m-es távolságban kell leültetni. Lehetőség szerint a vizsgálatot végző is üljön. Ha a szoba megvilágítása nem megfelelő, akkor helyi fényforrást (pl. vizsgáló vagy olvasólámpa) kell a vizsgálatot végző keze felé irányítani.
- A vizsgálat során először fel kell mérni, hogy a gyermek hajlandó-e – a sorban egymás után felmutatott kártyákon – az „Ammon” jelek (villák) irányát megmutatni. (Tapasztalatok szerint a hajlandóság növelhető, ha a jeleket „robotkéznek” nevezzük, és arra kérjük a gyermeket, hogy utánozza a robotot.) Ha hajlandó erre, akkor a vizsgálat – az „Ammon” jelek csökkenő méretű sorrendben történő felmutatásával – a falitáblánál megszokott módon végezhető el.
- Ha nem tudja, vagy nem akarja megmutatni, hogy melyik irányba mutat a villa, akkor lehet a kártyák másik oldalán levő rajzokat segítségül hívni. A gyermek kezébe kell adni az „**összesítő kártyát**”. A gyermek vagy a felismert figura nevét mondja meg, vagy a kezében levő összesítő lapon megmutathatja, hogy mit lát a felmutatott kártyán. Ha ilyen módon sikerült eljutni a legkisebb felismert rajzokig, akkor érdemes megpróbálni, hogy a kártya másik oldalán levő „Ammon” jelet felismeri-e.

A vizsgálat eredménye tájékoztató jellegű!

Az eszköz nem laikus felhasználók, hanem egészségügyi szakemberek (orvosok, védőnők stb.) számára készült!

Tájékoztató adatok:

- Gyártó neve: Medi-CAD Kft.
3531 Miskolc, Gyár u. 62-1.
Tel.: +36 46 369 377
e-mail: medicad@medicad.hu.
web: www.medicad.hu
- Megfelelőség jele: 
- 2017/745 EU rendelet szerinti osztályba sorolás: I. (1. szabály)
- Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT
- UDI-DI: 5999861787029
- Méretek:
 - A gyűrűskönyv mérete: 150x155x35 mm
 - A belső lapok mérete: 130x148x0,5 mm
- A könyv és a lapok anyaga: laminált nyomdai karton

VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok


Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT

UDI-DI: 5999861787029

A „VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok” gyűrűskönyvben, egy olyan segédeszköz, amely a kisgyermekek látásélesség-vizsgálatához nyújt segítséget abban az esetben, ha a vizsgálat a VISUS-S vagy VISUS-D látásélesség-vizsgáló táblával a hagyományos módon nem végezhető el. A vizsgálatot a lapok (kártyák) segítségével „játékos” formában lehet elvégezni.

A gyűrűskönyv 12 db „**Vizsgáló kártyát**”, 1 db „**Összesítő kártyát**” és 1 db „**Segédkártyát**” tartalmaz. A **Vizsgálókártyák** egyik oldalán a Kettessy-tábla egyik „Ammon” jele (villa), a hátoldalukon egy vagy több, hasonló láthatóságú ábra található, az **Összesítő kártyán** látható rajzok („óvodai jelek”) közül. A 3 m-es vizsgálati távolságú Kettessy-féle tábla „Ammon jeles” változata középső oszlopának mindegyik jele megtalálható a kártyasorozat egy-egy lapján. Minden kártyán jelölve van, hogy mennyi a rajta levő Ammon-jel visus-értéke. *(Rendelhető „C” jeles változatban is.)*

A segédkártyán a szabványos „Ammon” jeles Kettessy-féle tábla kicsinyített rajza látható. A lap szélén az ábrák visus-értéke is fel van tüntetve, így a vizsgálatot végző személy azonosítani tudja, hogy a kártyákon található jelek a falitáblán hol helyezkednek el.

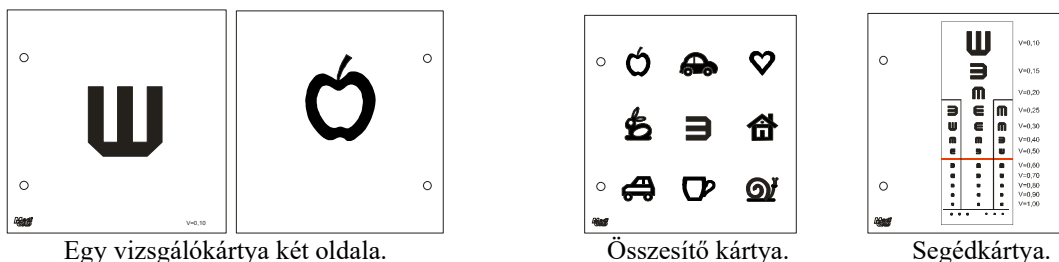

Egy vizsgálókártya két oldala.

Összesítő kártya.

Segédkártya.


A látásélesség-vizsgálat menete:

- A vizsgálatot jól megvilágított helyiségben kell végezni. A gyermekkel szemben nem lehet fényforrás vagy ablak.
- A kisgyermeket a vizsgálatot végző személytől 3 m-es távolságban kell leültetni. Lehetőség szerint a vizsgálatot végző is üljön. Ha a szoba megvilágítása nem megfelelő, akkor helyi fényforrást (pl. vizsgáló vagy olvasólámpa) kell a vizsgálatot végző keze felé irányítani.
- A vizsgálat során először fel kell mérni, hogy a gyermek hajlandó-e – a sorban egymás után felmutatott kártyákon – az „Ammon” jelek (villák) irányát megmutatni. (Tapasztalatok szerint a hajlandóság növelhető, ha a jeleket „robotkéznek” nevezzük, és arra kérjük a gyermeket, hogy utánozza a robotot.) Ha hajlandó erre, akkor a vizsgálat – az „Ammon” jelek csökkenő méretű sorrendben történő felmutatásával – a falitáblánál megszokott módon végezhető el.
- Ha nem tudja, vagy nem akarja megmutatni, hogy melyik irányba mutat a villa, akkor lehet a kártyák másik oldalán levő rajzokat segítségül hívni. A gyermek kezébe kell adni az „**összesítő kártyát**”. A gyermek vagy a felismert figura nevét mondja meg, vagy a kezében levő összesítő lapon megmutathatja, hogy mit lát a felmutatott kártyán. Ha ilyen módon sikerült eljutni a legkisebb felismert rajzokig, akkor érdemes megpróbálni, hogy a kártya másik oldalán levő „Ammon” jelet felismeri-e.

A vizsgálat eredménye tájékoztató jellegű!

Az eszköz nem laikus felhasználók, hanem egészségügyi szakemberek (orvosok, védőnők stb.) számára készült!

Tájékoztató adatok:

- Gyártó neve: Medi-CAD Kft.
3531 Miskolc, Gyár u. 62-1.
Tel.: +36 46 369 377
e-mail: medicad@medicad.hu.
web: www.medicad.hu
- Megfelelőség jele: 
- 2017/745 EU rendelet szerinti osztályba sorolás: I. (1. szabály)
- Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT
- UDI-DI: 5999861787029
- Méretek:
 - A gyűrűskönyv mérete: 150x155x35 mm
 - A belső lapok mérete: 130x148x0,5 mm
- A könyv és a lapok anyaga: laminált nyomdai karton

VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok


Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT

UDI-DI: 5999861787029

A „VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok” gyűrűskönyvben, egy olyan segédeszköz, amely a kisgyermekek látásélesség-vizsgálatához nyújt segítséget abban az esetben, ha a vizsgálat a VISUS-S vagy VISUS-D látásélesség-vizsgáló táblával a hagyományos módon nem végezhető el. A vizsgálatot a lapok (kártyák) segítségével „játékos” formában lehet elvégezni.

A gyűrűskönyv 12 db „**Vizsgáló kártyát**”, 1 db „**Összesítő kártyát**” és 1 db „**Segédkártyát**” tartalmaz. A **Vizsgálókártyák** egyik oldalán a Kettessy-tábla egyik „Ammon” jele (villa), a hátoldalukon egy vagy több, hasonló láthatóságú ábra található, az **Összesítő kártyán** látható rajzok („óvodai jelek”) közül. A 3 m-es vizsgálati távolságú Kettessy-féle tábla „Ammon jeles” változata középső oszlopának mindegyik jele megtalálható a kártyasorozat egy-egy lapján. Minden kártyán jelölve van, hogy mennyi a rajta levő Ammon-jel visus-értéke. *(Rendelhető „C” jeles változatban is.)*

A segédkártyán a szabványos „Ammon” jeles Kettessy-féle tábla kicsinyített rajza látható. A lap szélén az ábrák visus-értéke is fel van tüntetve, így a vizsgálatot végző személy azonosítani tudja, hogy a kártyákon található jelek a falitáblán hol helyezkednek el.

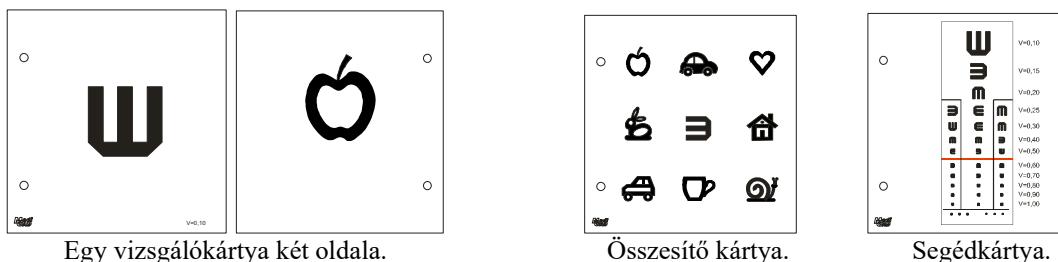


A látásélesség-vizsgálat menete:

- A vizsgálatot jól megvilágított helyiségben kell végezni. A gyermekkel szemben nem lehet fényforrás vagy ablak.
- A kisgyermeket a vizsgálatot végző személytől 3 m-es távolságban kell leültetni. Lehetőség szerint a vizsgálatot végző is üljön. Ha a szoba megvilágítása nem megfelelő, akkor helyi fényforrást (pl. vizsgáló vagy olvasólámpa) kell a vizsgálatot végző keze felé irányítani.
- A vizsgálat során először fel kell mérni, hogy a gyermek hajlandó-e – a sorban egymás után felmutatott kártyákon – az „Ammon” jelek (villák) irányát megmutatni. (Tapasztalatok szerint a hajlandóság növelhető, ha a jeleket „robotkéznek” nevezzük, és arra kérjük a gyermeket, hogy utánozza a robotot.) Ha hajlandó erre, akkor a vizsgálat – az „Ammon” jelek csökkenő méretű sorrendben történő felmutatásával – a falitáblánál megszokott módon végezhető el.
- Ha nem tudja, vagy nem akarja megmutatni, hogy melyik irányba mutat a villa, akkor lehet a kártyák másik oldalán levő rajzokat segítségül hívni. A gyermek kezébe kell adni az „**összesítő kártyát**”. A gyermek vagy a felismert figura nevét mondja meg, vagy a kezében levő összesítő lapon megmutathatja, hogy mit lát a felmutatott kártyán. Ha ilyen módon sikerült eljutni a legkisebb felismert rajzokig, akkor érdemes megpróbálni, hogy a kártya másik oldalán levő „Ammon” jelet felismeri-e.

A vizsgálat eredménye tájékoztató jellegű!

Az eszköz nem laikus felhasználók, hanem egészségügyi szakemberek (orvosok, védőnők stb.) számára készült!

Tájékoztató adatok:

- Gyártó neve: Medi-CAD Kft.
3531 Miskolc, Gyár u. 62-1.
Tel.: +36 46 369 377
e-mail: medicad@medicad.hu.
web: www.medicad.hu
- Megfelelőség jele: 
- 2017/745 EU rendelet szerinti osztályba sorolás: I. (1. szabály)
- Basic UDI-DI: 5999861787VISUS01XT
- UDI-DI: 5999861787029
- Méretek:
 - A gyűrűskönyv mérete: 150x155x35 mm
 - A belső lapok mérete: 130x148x0,5 mm
- A könyv és a lapok anyaga: laminált nyomdai karton